

إقليم كوردستان - العراق
مجلس الوزراء
وزارة الصحة
المديرية العامة لصحة دهوك
قسم العقود العامة




Kurdistan Region – Iraq
Council of Ministers
Ministry of Health
General directorate of Health-Duhok

هه رێمی کوردستان - عێراق
نهجوهه نی وهزیران
وهزاره تی ته ندروستی
رێشه بهریا گشتی یا ساخه میا دهۆک
پشکا گرێه ستین گشتی

No.:
Date: / / 2023

کوردی ۲۷۲۳ / /

ژماره: ۹۹۵۱
رێکهوت: ۲۰۲۳ / ۱۳

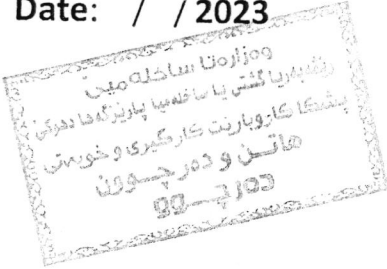

کومیانیا /

ب/ راگه هاندنا سه رێک کیمکرنا ژماره (15) دووباره

هه وه بێن هێژا داخازدکهین داکو پشکداریی د سه ر ئێک کیمکرنه کا نه بێنی دا بکه ن بۆ کرین ودا بێنکرنا که ره ستین نوژداری بۆ هوبا کونترولکرنا که گرتنی یا سه ر ب رێشه بهریا مه یا گشتی که لیدیف لیسته و مه رجین هه قیچ، و پشکیشکرنا دا بێنن یا سایی ب کوژمی (۵,۰۰۰,۰۰۰) بێنج ملیون دینارا ژ به نکه کا باوهر پیکری بیت ، ودقیق ته ندهر بگه هه نه مه ل رێکه فتی (۲۰۲۳/۹/۷) ده مژمیر (۱۱) یازده یی سبیدی.

بۆ زانین، دگه ل ریزگرتنی.

هه قیچ: لیسته و مه رج

د. افراسیاب موسی یونس
رێشه بهری گشتی
۲۰۲۳ / ۱ / ۱۳

وینه یه ک بۆ :

- نقیسینگه ها رێفه بهری گشتی، بۆ زانین و دگه ل ریزگرتنی.
- پشکا ده رمانسازی و پیدقیقیت نوژداری، نقیسارا هه وه یا ژماره (۸۳۷ ل ۲۰۲۳/۷/۱۷) بۆ زانین.
- دوسیا کاری.
- هوبا (A.T) ، بۆ راگه هاندنی.

گرێه ستین گشتی / خالد



شروط العقد

عنوان العقد : العقد السنوي للمستلزمات الطبية - احتياج وحدة السيطرة على العدوى

العقد السنوي رقم (15) 17/07/2023

على الشركة التي يرسى عليها العقد الالتزام بالشروط التالية:-

- 1- تتعهد الجهة التي يرسى عليها العقد باستبدال المواد المنتهية صلاحيتها والغير صالحة للإستعمال ضمن العقد بكتاب رسمي حتى بعد انتهاء العقد لأي سبب كان
- 2- أن يتم تجهيز المواد حسب احتياج الدائرة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلب المادة و حسب المواصفات المقدمة والمثبتة.
- 3- ان تحمل المواد تاريخ انتهاء مفعول اكثر من سنة لكل وجبة تجهيز وفي حالة كون المادة تحمل تاريخ انتهاء لاقل من ذلك يحق لقسم الصيدلة رفض المادة او قبولها حسب توفرها في القسم او احتياج الجهة الطالبة
- 4- يتحمل المجهز غرامة تأخيرية 1% من قيمة الطلب عن كل يوم تأخير حال عدم تقيده بالمدة المنصوص أعلاه او بسبب التأخير الناجم عن عدم التزام المجهز بالشروط الأخرى .
- 5- آخر موعد لقبول العروض (/ / 2023) الساعة الحادية عشر صباحاً
- 6- الدائرة غير ملزمة بقبول أو طاً العروض حال وجود ما يبرر ذلك.
- 7- الدائرة غير ملزمة بإحالة المواد جميعاً الى شركة واحدة ويتم الاختيار حسب الجودة والسعر
- 8- تكرار المخالفة من قبل الجهة المجهزة يعرضها للإدراج في القائمة السوداء.
- 9- يتم اهمال العطاءات المقدمة من قبل الجهات الغير مخولة رسمياً" بالمناجزة بالأدوية .
- 10- ترفض المواد المنقولة في الظروف الخزنية الغير الملائمة بنقلها (يراعى ظروف النقل الصحيح كما مثبتت على العبوة وخلاف ذلك تعتذر الدائرة عن إستلام اية مادة منقولة في ظروف خزنية مخالفة ترجع المادة وتعوض مع تطبيق الغرامة المذكورة في الفقرة 4 .
- 11- ترسل نماذج من المواد الى لجنة التحليل في دائرة الصحة / قسم الشراء لتدقيق النموذج.
- 12- يقارن ادنى العروض مع القيمة التخمينية في قسم الصيدلة لتقرير المبلغ المقدم او اعادة تقديم العطاءات
- 13- ان تكون الشركة المجهزة مسجلة في وزارة الصحة لاقليم كردستان ولديها اعمال مماثلة في التقديم سابقاً.
- 14- ان تكون المواد المجهزة مسجلة ومطلقة الصرف من وزارة الصحة لاقليم كردستان (KMCA) او وزارة صحة العراق
- 15- في حالة ظهور اية تغيرات فيزيائية او كيميائية في المادة المجهزة اثناء الخزن في المؤسسات الصحية يتحمل المجهز التعويض.
- 16- لا تتحمل الدائرة استحصا الموافقات الرسمية بإدخال المواد عدا تزويد المجهز بتأييد رسو العقد عليه.
- 17- ملاحظة املء كافة الحقول المضافة الى قائمة العرض وسيتم تدقيق ذلك والأسبقية لمن يوفر الشروط كاملة ولا يشترط قبول أو طاً العروض.
- 18- يهمل العرض المقدم من قبل الشركة حال عدم تدوين المعلومات المدونة ادناه مع التوقيع من قبل الصيدلاني المخول او المدير المفوض بتقديم العرض.

رقم التسجيل /

صاحب شركة / مذخر / مكتب / ...

إني السيد / ..

أتعهد بتنفيذ الفقرات المدونة أعلاه وخلاف ذلك اتحمل كل التبعات القانونية المترتبة على وعليه أوقع الترامي بالعقد .

الختم

التوقيع
الاسم

ملاحظة / العرض يقدم في ظروف موقع ومختوم بختم المحل



S.NO	ITEM NAME	ORIGIN يرجى ذكر المنشأ	PRICE	UNIT	NOTES
1	Bowie-Dick simulation Test indicator. Bowie-Dick test system for the daily steam penetration test in pre-vacuum sterilizers			TEST	
2	Package monitoring indicator.Chemical integrator specific for steam sterilization at 121°C and 135°C			TEST	
3	BMS Batch Monitoring System.Batch Monitoring system for steam sterilization processes at 134 °C			TEST	
4	Test Vial for Monitoring Ultrasonic Energy During Reprocessing of Instruments in Ultrasonic Baths.Kit contains vials, ready for use, immediate results.			TEST	
5	Test Vial for detection of blood residues on surgical instruments and surfaces.Kit contains vials, ready for use, immediate results.			TEST	
6	Surface Disinfectant Wipes Ready to use, Aldehyde and alcohol free hygiene wipes.Bucket (rolls) contains wipes, ready for use.			WIPES-BUCKET	
7	Disposable Sharps collection boxes.Yellow color, firm plastic, leak proof, tear resistant, Bio Hazard symbol and Label in black color, one way opening cup			5L-CONTAINER	

